



ELEKTRONISCHER BRIEF

TechniSat Digital GmbH
TechniPark
D-54550 Daun/Eifel

**REGIONALSTELLE
GEWERBEAUF SICHT**

Deworastraße 8
54290 Trier
Telefon 0651 4601-0
Telefax 0651 4601-200
Poststelle@sgdnord.rlp.de
www.sgd nord.rlp.de

17.07.2020

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner(in)/ E-Mail	Telefon/Fax
24.2/2.1	16.07.2020	Michael Reuter	0651 4601-5211
Bitte immer angeben! Zeichen		Michael.Reuter@sgdnord.rlp.de	0261 120-885211

Bestätigung

(PSA-RLP-SGDN-24-003)

gemäß § 9 Absatz 3 der Verordnung zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Produkten des medizinischen Bedarfs bei der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten Epidemie
(Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung – MedBVSV)

Ausweislich des Prüfberichtes Nr. 20-002405-PR01 (PB-P01-09-de-01) des ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim erfüllt das Produkt

- Modell: TECHNIMASK 2000 (Chargennummer: Ruhlamat02_M16)
- Hersteller: TechniSat Digital GmbH, Julius Saxler-Straße 3, 54550 Daun

die Anforderungen des „Prüfgrundsatzes für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken (CPA)“¹ (Schnelltest).

¹ <http://www.zls-muenchen.de/aktuell/index.htm>
1/5

Kernarbeitszeiten
09.00-12.00 Uhr
14.00-15.30 Uhr
Freitag: 09.00-13.00 Uhr

Verkehrsbindung
5 Minuten Fußweg vom
Hauptbahnhof

Parkmöglichkeiten
Ostallee Parkhaus
„Alleencenter“



Es darf nur für die Dauer der Corona Pandemie auf dem deutschen Markt als verkehrsfähig und nur zum **Zwecke des Infektionsschutzes** angesehen werden. Aufgrund des Bewertungsverfahrens darf an diese Produkte keine CE-Kennzeichnung angebracht werden.

Diese Bescheinigung ist in Kopie an alle Käufer bzw. Zwischenhändler bis zum Verwender weiterzugeben.

Auf Verlangen der Behörde hat jeder Händler eine Liste mit Namen und Kontaktdaten der Käufer/ Empfänger, sowie Anzahl der Produkte zur Verfügung zu stellen.

Im Auftrag

gez. Michael Reuter



Bilddokumentation:



Bild 1 Verpackung der Probekörper



Bild 2 Verpackung der Probekörper



Bild 3 Verpackungseinheit



Bild 4 Ansicht des Probekörpers

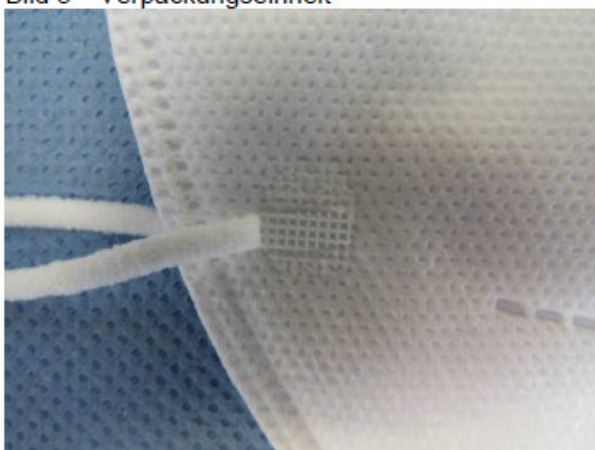


Bild 5 Anbindung der Kopfbänderung



Bild 6 Nahtverschweißungen



Bild 7 Nasenbügel



Bild 8 Atemschutzmaske aufgetrennt



Bild 9 Aufschriften / Aufdrucke am Probekörper



Bild 10 Beipackzettel



Bild 1 Gebrauchsanweisung des Herstellers auf dem Karton

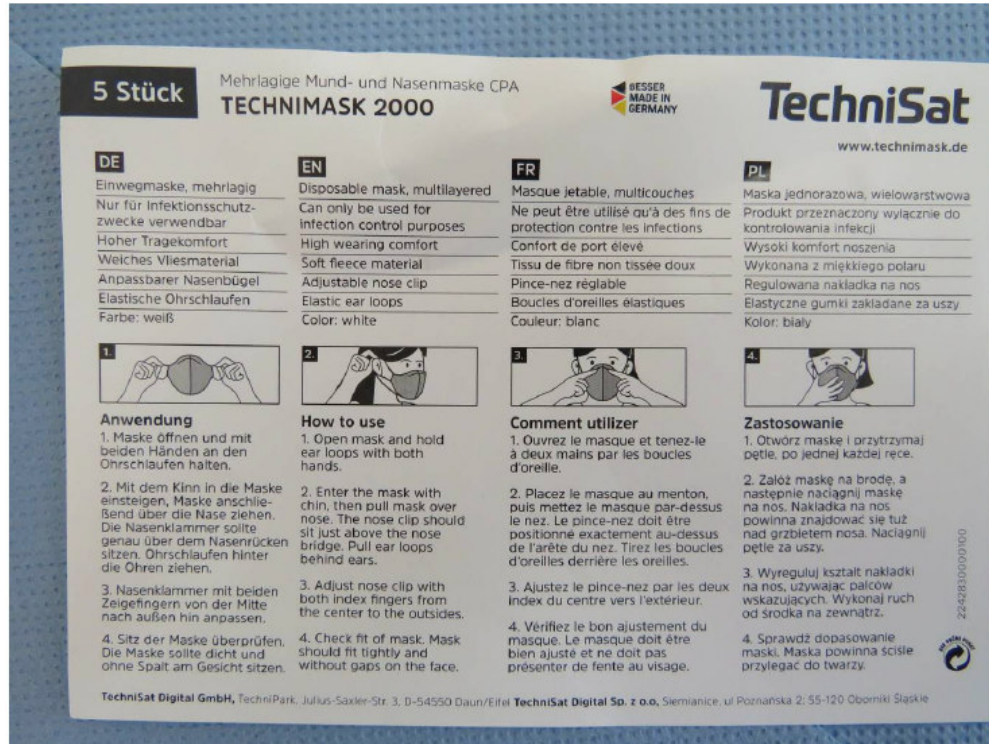


Bild 2 Gebrauchsanweisung des Herstellers als Beipackzettel

Bilder: ift Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Straße 7-9, 83026 Rosenheim